



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»

место нахождения: ул. Гурского, 30, каб. 101-505, 220015, г. Минск, Республика Беларусь
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876

номер телефона: +375 173756784, **адрес электронной почты:** marketing@belgastechnika.by
в лице директора Оболенского Евгения Вячеславовича

заявляет, что дефектоскоп для контроля качества изоляции ДКИ-3

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»

место нахождения: ул. Гурского, 30, каб. 101-505, 220015, г. Минск, Республика Беларусь
ТУ РБ 100270876.087-2000 «Дефектоскоп для контроля качества изоляции ДКИ-3»

код ТН ВЭД ЕАЭС 9031 80 380 0

серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний № 24164 ЭМС от 30.08.2024, выданного испытательным центром Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0085; сертификата соответствия № ВУ/112 05.01. 003.01 00696 от 13.06.2023, выданного органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации ВУ/112 003.01;

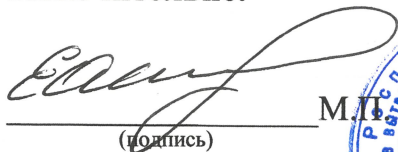
схема декларирования соответствия – бд

Дополнительная информация:

Примененный стандарт: ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний».

Дефектоскоп для контроля качества изоляции ДКИ-3 должен храниться в складских помещениях при температуре от минус 50 до плюс 50 °С, при относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре 25 °С и отсутствии агрессивных паров (газов). Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с момента изготовления дефектоскопа. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев со дня отправки потребителю. Средний срок службы должен быть не менее 8 лет. Средняя наработка на отказ должна быть не менее 5000 часов.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.01.2030 включительно.


(подпись)

М.П.



Оболенский Евгений Вячеславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии
Дата регистрации декларации о соответствии

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 003.02 15417
15.01.2025

